

Standaard Silicone 5000 pakkingen



5000 serie silicone pakkingen

Kenmerken en voordelen

- Met laser geëtste lot nummering voor volledige traceerbaarheid van het materiaal (ook niet met laser geëtste versie beschikbaar)
- Ontworpen volgens ASME-BPE-normen
- Voldoet aan USP klasse VI en is vrij van dierlijke stoffen (ADCF)
- Voldoet aan FDA regelgeving CFR 21 177.2600
- Gamma steriel en autoclaveerbaar
- Laag extractable profiel
- Dubbele zakken en heat-sealed




Technische specificaties

	Standaard Silicone 5000 pakkingen
Pakkingtype	Zonder flens
Binnendiameterbereiken	22.9 - 147.8 mm (0.9 - 5.82 in)
Buitendiameterbereiken	50.3 - 165.4 mm (1.98 - 6.51 in)
Grootte	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 6 in
Aantal	25 PCS
Certificatie en compliance	ADCF, Fase Eur. 3.1.9, ISO10993, ISO-klasse 7, USP <788>, USP <85>, USP <87>, USP klasse VI
Bedrijfstemperatuurbereiken	-55 °C tot 210 °C (-67 °F tot 410 °F)
Houdbaarheid	5 jaar
Gammastabiliteit	Max. 50 kGy

Constructie materialen

	Standaard Silicone 5000 pakkingen
Materiaal	Platinum-cured silicone

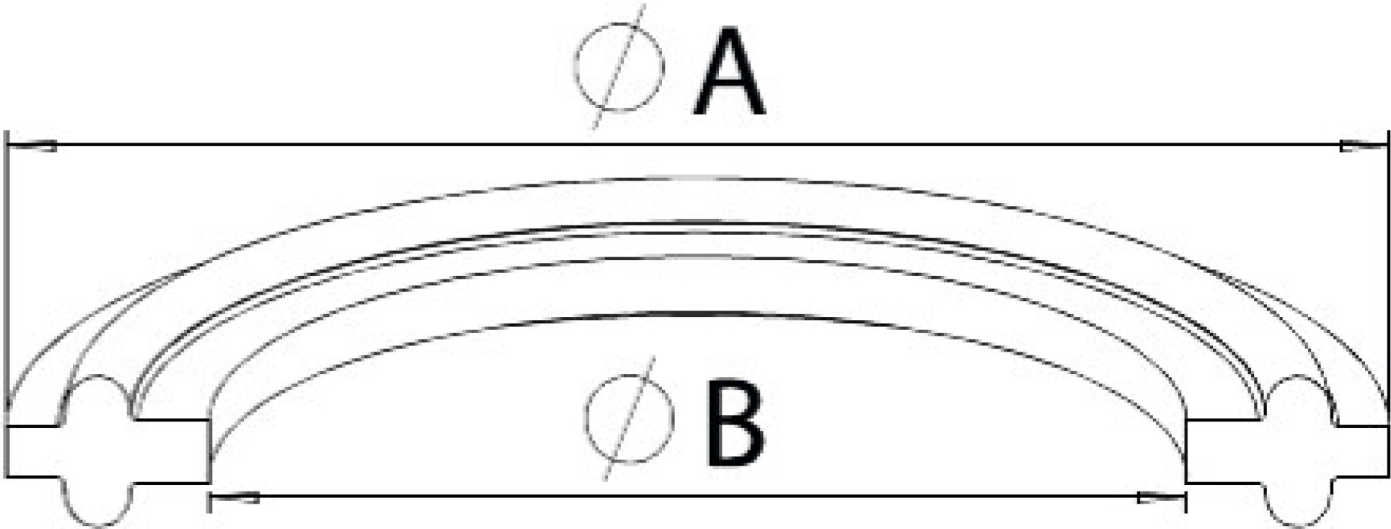

BioPure hoogzuivere platinum-cured silicone pakking - laser geëts				
Onderdeelnummer	Inchmaat	Buitendiameter in inches (A)	Binnendiameter in inches (B)	Aantal
5001.0100.025	1	1,98 (50,3)	0,90 (22,9)	25
5001.0150.025	1 1/2	1,98 (50,3)	1,40 (35,6)	25
5001.0200.025	2	2,52 (64,0)	1,90 (48,3)	25
5001.0250.025	2 1/2	3,05 (77,5)	2,40 (61,0)	25
5001.0300.025	3	3,58 (90,9)	2,90 (73,7)	25
5001.0400.025	4	4,68 (118,9)	3,87 (98,3)	25
5001.0600.025	6	6,51 (165,4)	5,82 (147,8)	25
BioPure hoogzuivere platinum-cured silicone pakking				
Onderdeelnummer	Inchmaat	Buitendiameter in inches (A)	Binnendiameter in inches (B)	Aantal
5201.0100.025	1	1,98 (50,3)	0,90 (22,9)	25
5201.0150.025	1 1/2	1,98 (50,3)	1,40 (35,6)	25
5201.0200.025	2	2,52 (64,0)	1,90 (48,3)	25
5201.0250.025	2 1/2	3,05 (77,5)	2,40 (61,0)	25
5201.0300.025	3	3,58 (90,9)	2,90 (73,7)	25
5201.0400.025	4	4,68 (118,9)	3,87 (98,3)	25
5201.0600.025	6	6,51 (165,4)	5,82 (147,8)	25

Disclaimer: De informatie in dit document wordt geacht juist te zijn. Watson-Marlow Limited kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de informatie en behoudt zich het recht voor om specificaties zonder kennisgeving te wijzigen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren of het product geschikt is voor de bedoelde toepassing. Watson-Marlow en WMArchitect zijn geregistreerde handelsmerken van Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator en Q-Clamp zijn handelsmerken van BioPure Technology Limited. Tri-Clamp is een geregistreerd handelsmerk van Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
05 November 2025