

Juntas pequenas em silicone da série RXPX



Juntas de silicone da série RXPX

Recursos e benefícios

- Projetadas de acordo com padrões ASME-BPE
- Compatível com USP Classe VI e livre de componente de origem animal
- Compatível com normas FDA do Código de Regulamentos Federais dos EUA número 21 177 2600
- A numeração de lote permite a rastreabilidade dos produtos
- Fabricado e embalado em sala limpa com certificação ISO 14644-1 Classe 7
- Embalagem única de polietileno (PE)




Especificações técnicas

	Juntas pequenas em silicone da série RXPX
Tipo de junta	Sem flange
Diâmetro interno	10.9 - 16 mm (0.43 - 0.63 pol.)
Diâmetro externo	21.6 mm (0.85 pol.)
Dimensões	0.5, 0.75 pol
Quantidade	25 PCS
Certificação e conformidade	ADCF, Classe ISO 7, USP Classe VI
Limites das temperatura de funcionamento	-55 °C a 210 °C (-67 °F a conMaxMaxOperatingTemperatureF[conMaxMaxOperatingTemperatureF °F])
Prazo de validade	5 anos
Estabilidade gama	Máx. 50 kGy

Materiais de construção

	Juntas pequenas em silicone da série RXPX
Material	Silicone curado com platina

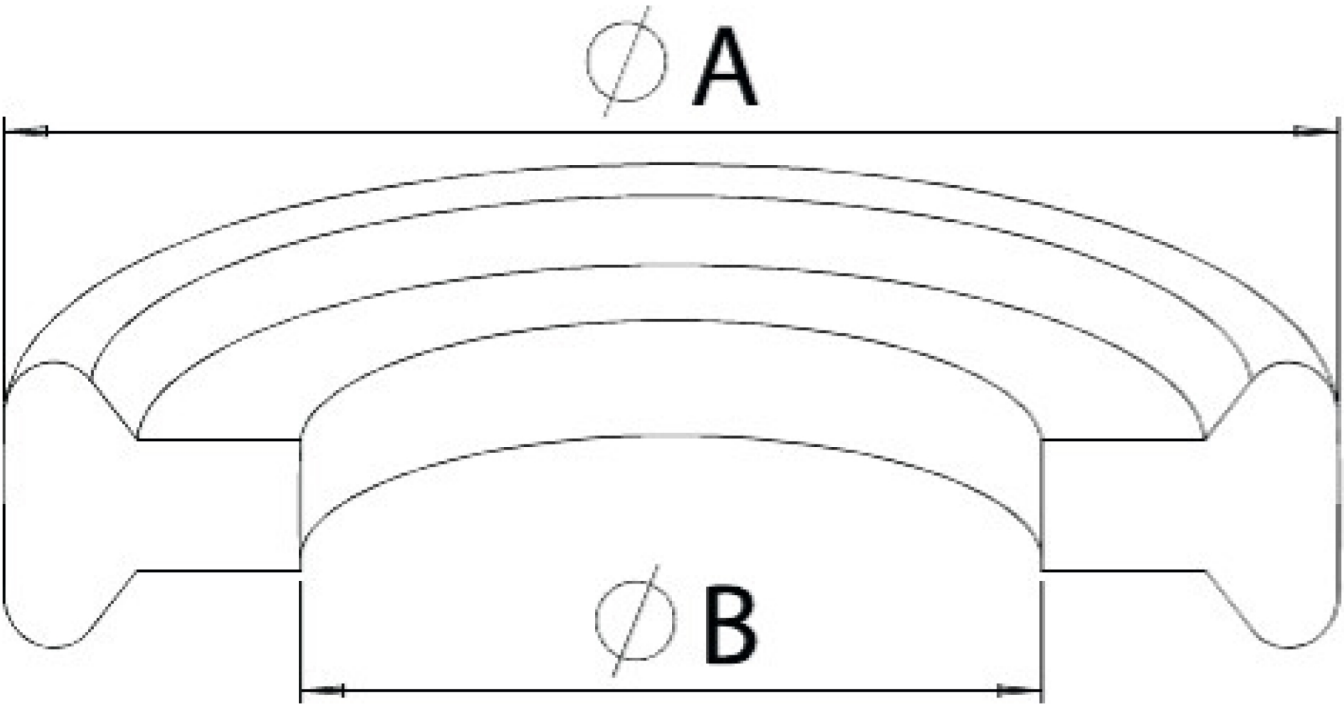

Código do produto	Tamanho em polegadas	D.E. pol. (A)	D.I. pol. (B)	Quantidade
42RXPX-050-25	1/2	0,85 (21,6)	0,43 (10,9)	25
42RXPX-075-25	3/4	0,85 (21,6)	0,63 (16,0)	25

Isenção de responsabilidade: As informações contidas neste documento são consideradas corretas, porém a Watson-Marlow Limited não se responsabiliza por nenhum erro que este documento possa conter e reserva-se o direito de alterar as especificações sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador garantir que o produto seja o adequado para a sua aplicação. Watson-Marlow e WMArchitect são marcas comerciais registradas da Watson-Marlow Limited. BioClamp, BioBarb, FlatBioEndCap, BioEndCap, BioValve, BioTube applicator e Q-Clamp são marcas comerciais da BioPure Technology Limited. Tri-Clamp é uma marca registrada da Alfa Laval Corporate AB.



wmfts.com/global
13 October 2025